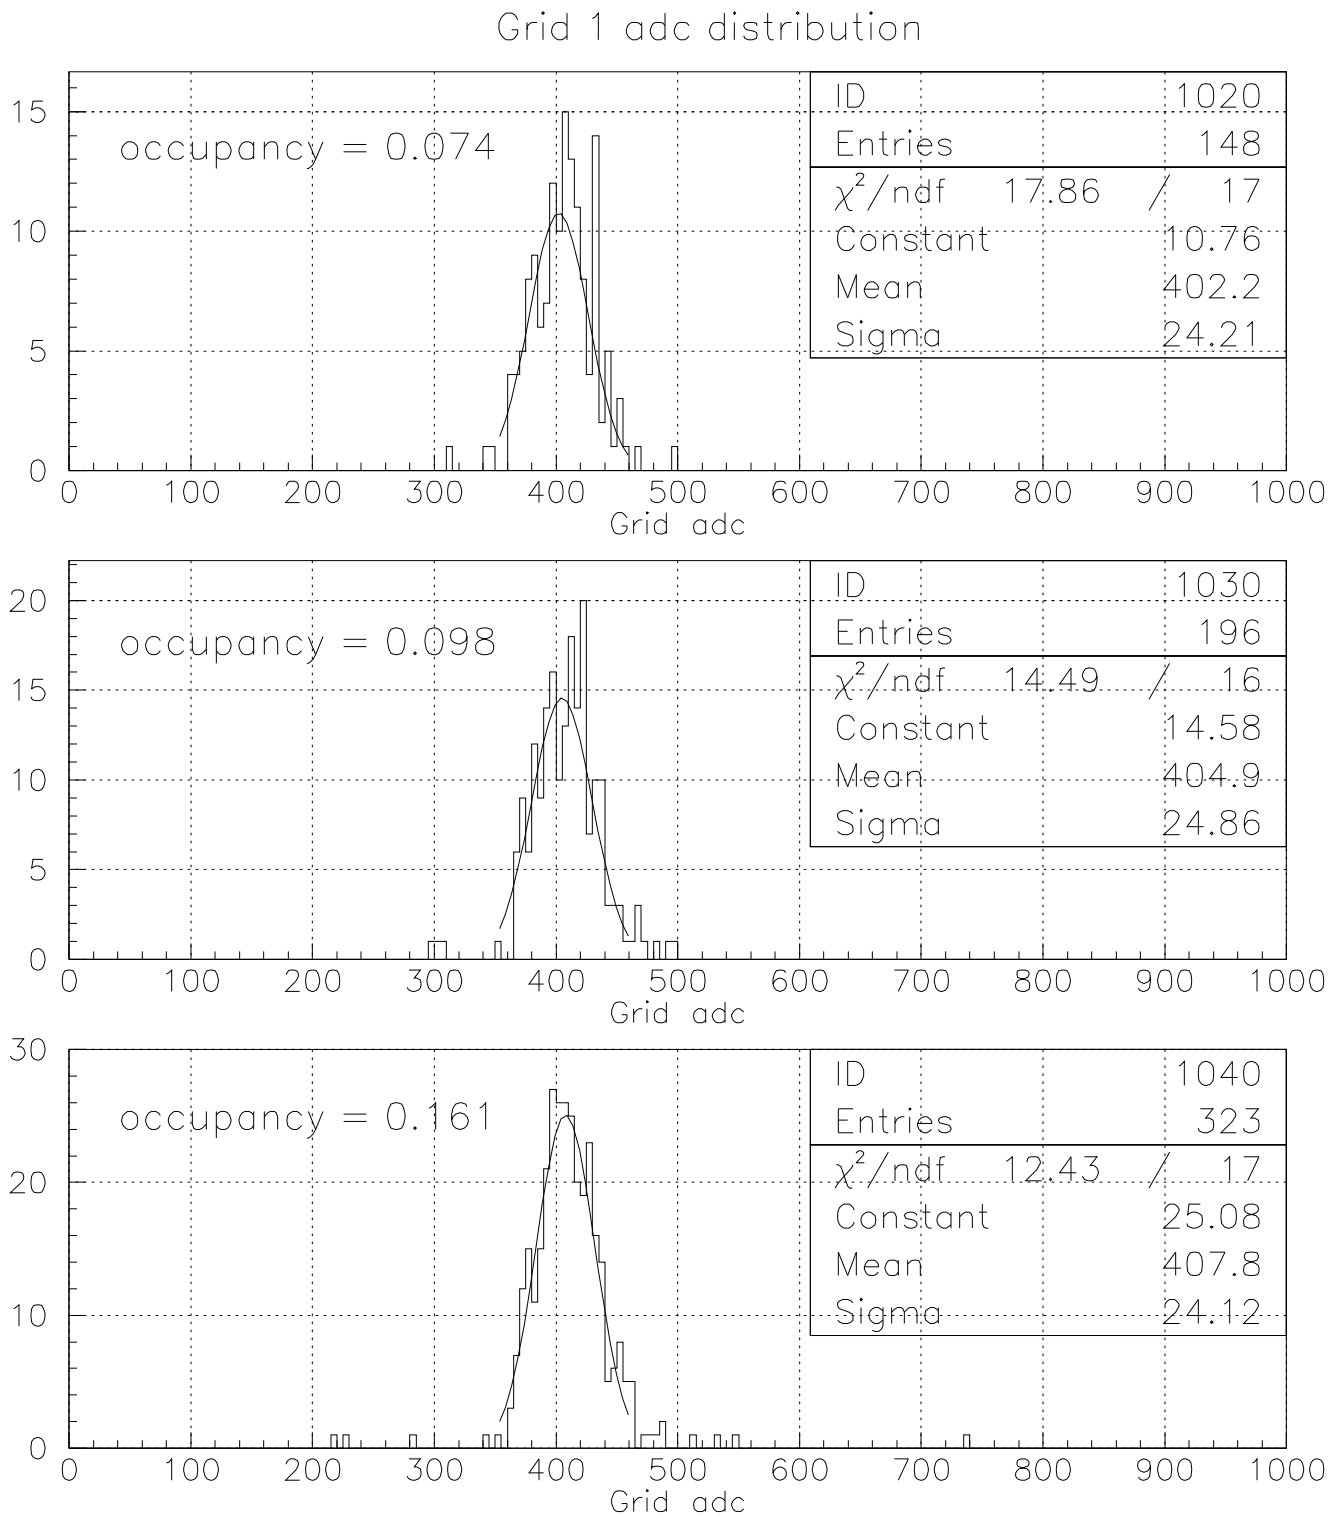
Grid 1 adc distribution
occupancy = 0.074
ID 1020
Entries 148
χ²/ndf 17.86 / 17
Constant 10.76
Mean 402.2
Sigma 24.21
Grid adc
occupancy = 0.098
ID 1030
Entries 196
χ²/ndf 14.49 / 16
Constant 14.58
Mean 404.9
Sigma 24.86
Grid adc
occupancy = 0.161
ID 1040
Entries 323
χ²/ndf 12.43 / 17
Constant 25.08
Mean 407.8
Sigma 24.12
Grid adc